
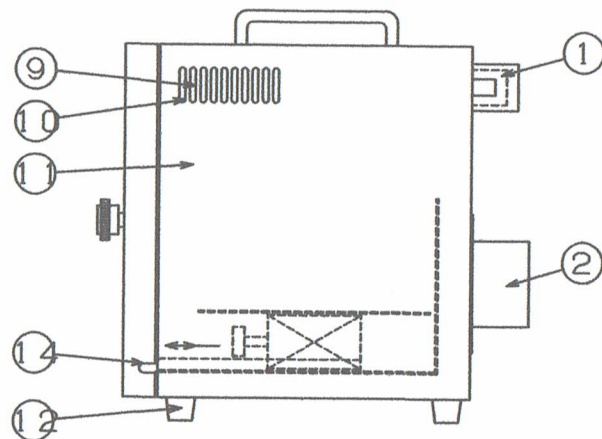
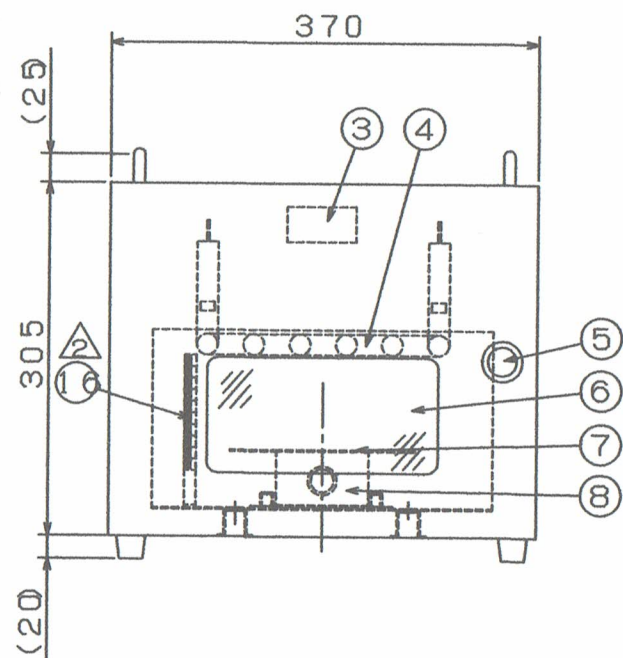


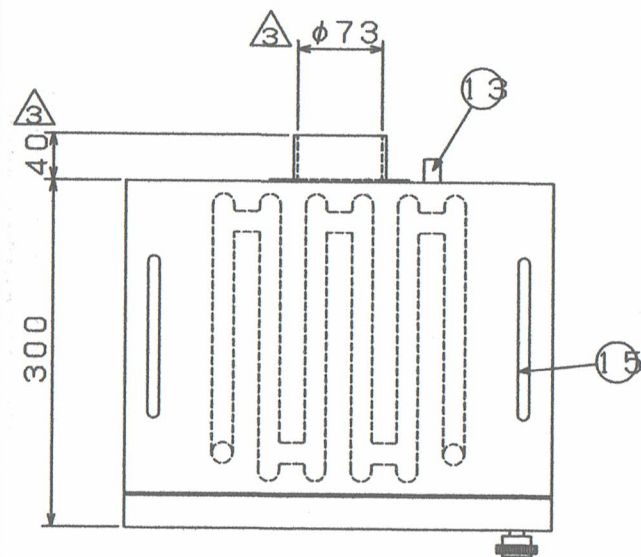

オプション(註1) PL21-200 : ノーマル
 ② PL21-200S : スケール付

16	スケール	②	オプション(註1)	1
15	取手			2
14	UV計リード穴		φ8以下	1
13	ページ穴	SUS-304	M5タップ	1
12	ゴム足			4
11	筐体	SUS-304	ヘアライン	1
10	フィルター内蔵			2
9	吸気孔			2
8	高さ調整治具	ラボジャッキ	ランプ~80mm	1式
7	試料台	SUS-304	□200	1
6	窓ガラス		254nm線カット	1
5	取手	ダイヤル式	扉開閉用	1
4	UVランプ(200W)	合成石英	③ EUV200GS-14	1
3	ランプ交換端子台		TS-615 4P	1
2	排気用ダクト口	SUS-304	φ75ホース用	1
1	電源接続端子台	カバー付	TS-615 4P	1

④	05/12/26	図面枠更新	森	
③	02/12/19	寸法訂正 ランプ型番変更(訂正)	石黒	江本
②	02/12/09	オプションとしてスケール追加	林	江本
①	95/03/06	外面ヘアラインとする。	石黒	石黒

部品番号	個数	部品名	材料	備考
名称	Drawing-DWG	承認	審査	設計
公差等級	3を越え6以下	±0.5	94.08.30	94.08.30
JS B04.05	6を越え30以下	±1	94.08.30	94.08.30
V級	30を越え120以下	±1.5	石黒	石黒
	120を越え400以下	±2.5	石黒	石黒
	400を越え1000以下	±4		
	1000を越え2000以下	±6		
	2000を越え	±8		
図面番号	2-02653	REV		
図面名	光表面処理装置			
型名	21-200(S)			
尺	1:5	第3角法	AS	